

DUNKELFELDKONTROLLE 1

SYMBIO-HARMONIZER MOBILE

Patient weibl., 56 J.

- Neutrale Blutabnahme am Ohrläppchen vor dem Telefonat
- Blutabnahme nach 3 minütigem Telefonat ohne dem Harmonizer Mobile mit Smartphone
- Blutabnahme nach 3 minütigem Telefonat mit dem Harmonizer Mobile
- Alle Abnahmen wurden doppelt ausgeführt um Abnahmefehler auszuschließen
- Das benützte Telefon hatte vorher noch nie Kontakt zu dem Harmonizer Mobile
- Zeitlicher Abstand zwischen den Telefonaten ca. 10 min.

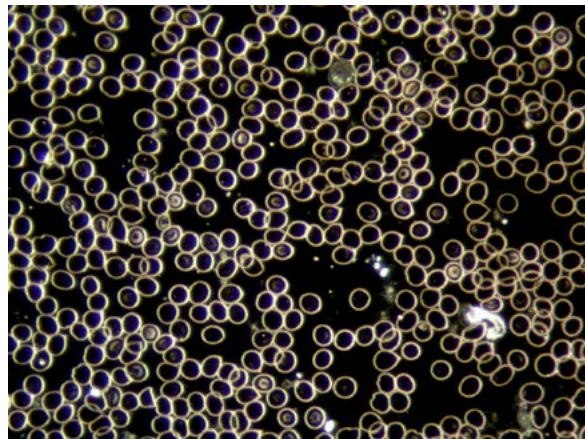


BILD 1:
BLUTABNAHME OHNE KONTAKT ZUM
HANDY

Das neutrale Bild zeigt leichte Adhäsionen jedoch keine Filitbildung.

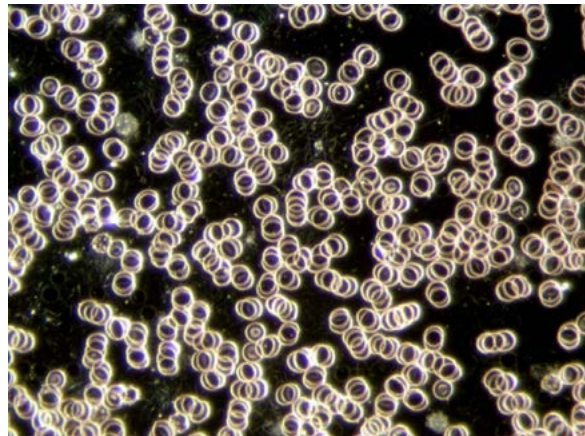


BILD 2:
NACH 3 MINÜTIGEM TELEFONAT OHNE DEM
SYMBIO-HARMONIZER MOBILE

Deutlich zu erkennen ist vermehrte Verklumpung und der Beginn einer Geldrollenbildung. Ebenfalls deutlich ist die Filitbildung (oxidativer Stress, beschleunigte Gerinnung), die in Bild 1 absolut nicht vorhanden ist.

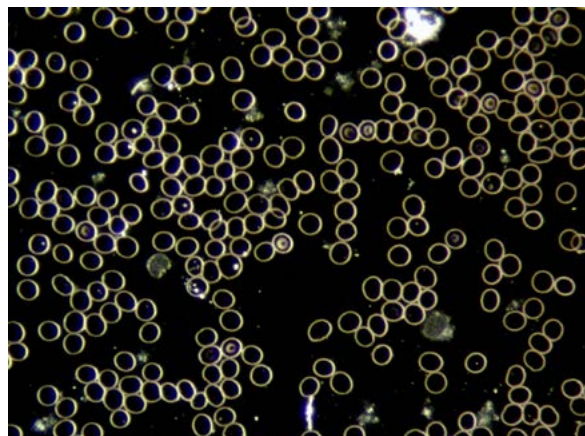


BILD 3:
NACH 3 MINÜTIGEM TELEFONAT MIT DEM
SYMBIO-HARMONIZER MOBILE

Der Unterschied zu Bild 2 ist so deutlich als ob eine Therapie gemacht wurde. Kein Ansatz einer Geldrollenbildung oder Verklumpung. Absolut keine Filitbildung.

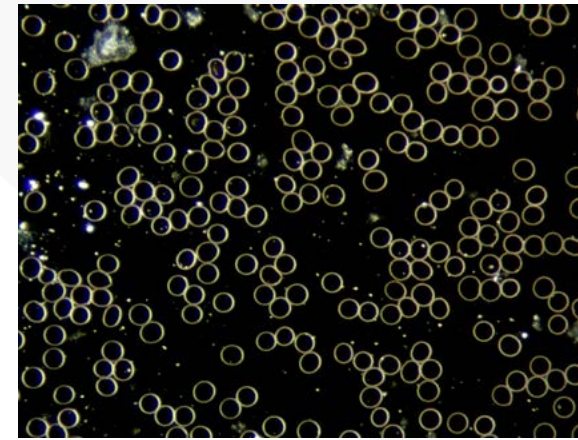


BILD 4:
NACH 3 MINÜTIGEM TELEFONAT MIT DEM
SYMBIO-HARMONIZER MOBILE

Absichtlich habe ich Bild 4 dazu gefügt weil der Unterschied so erstaunlich ist. Natürlich gelten die schon in Bild 3 erwähnten Veränderungen auch für Bild 4.

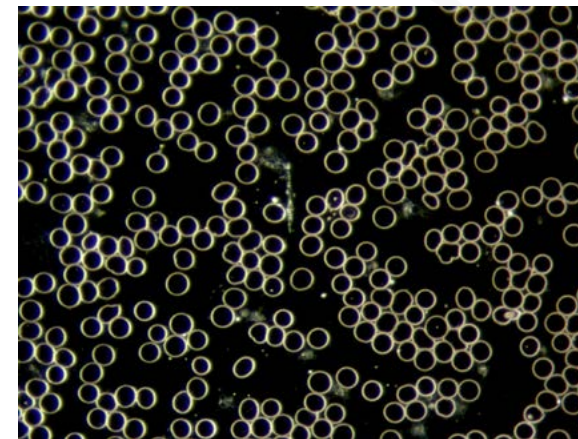


BILD 5:
NACH 3 MINÜTIGEM TELEFONAT MIT DEM
SYMBIO-HARMONIZER MOBILE

Und weil es so erstaunlich ist hab ich noch ein Bild mit dem Harmonizer Mobile nach 3 min. telefonieren hinzugefügt. Es scheint sogar als ob die Oberflächenspannung der Erythrozyten verbessert wurde.

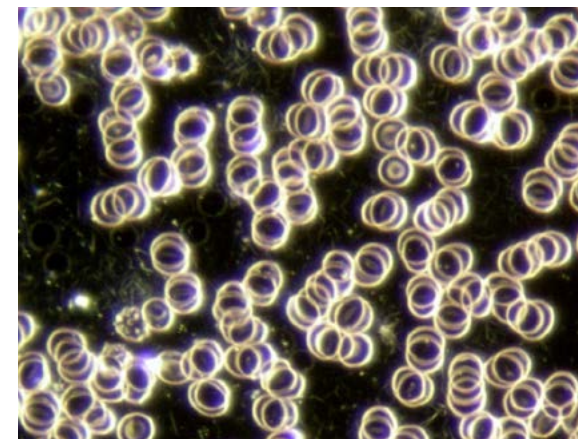


BILD 6:

Bild 2 nochmal in groß.

FAZIT

- Nach 3 min. telefonieren mit dem Handy ohne dem Harmonizer Mobile verändert das Blut seine Fließeigenschaften.
- Oxidativer Stress macht sich bemerkbar anhand der deutlichen Filitbildung!
- Das Blut verändert sich in Richtung Geldrollenbildung und Adhäsionen.
- Die Anwendung des Harmonizer Mobile zeigt meiner Meinung nach eine erstaunliche Beeinflussung was die oxidative Stressbelastung durch Elektrosmog betrifft, ebenso die Gerinnungsbedingungen, die die Fließeigenschaften betrifft.

***Feel secure.
Feel better.***

symbio
HARMONIZER



Zentrale Österreich
Symbio-Harmonizer GmbH
Gangsteig 2 • 5082 Grödig • Österreich
Tel.: 0043 6246 93252
Fax: 0043 6246 93252 14
E-Mail: office@symbio-harmonizer.com
Web: www.symbio-harmonizer.com



Zentrale Schweiz
Symbio-Harmonizer Schweizer Handels GmbH
Berneckerstr. 9 • 9493 AU (SG) • Schweiz
Tel.: 0041 715 111 389
Fax: 0041 715 111 319
E-Mail: office@symbio-harmonizer.ch
Web: www.symbio-harmonizer.ch