



Symbioceuticals – Harmonizer Mobile




Proband 1 Harmonizer Mobile

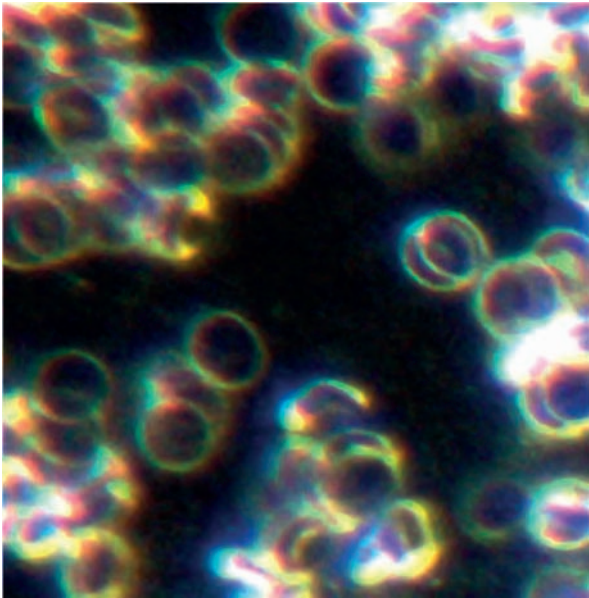

Dunkelfeldaufnahme vor
dem Telefonat

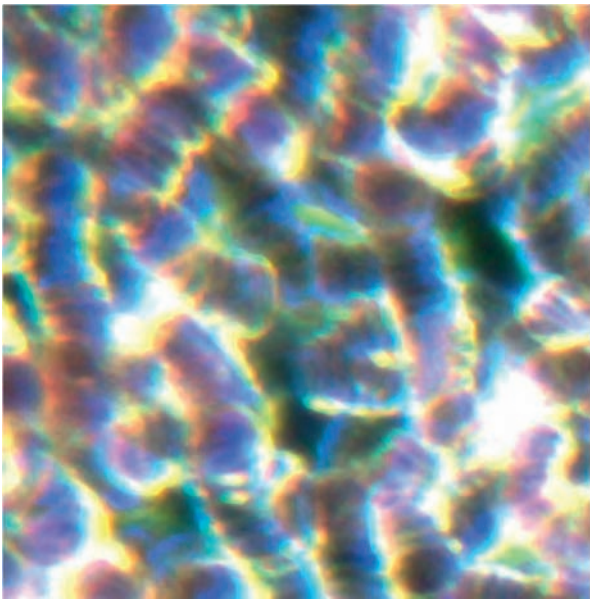


Dunkelfeldaufnahme nach
dem Telefonat mit
handelsüblichen
Smartphone

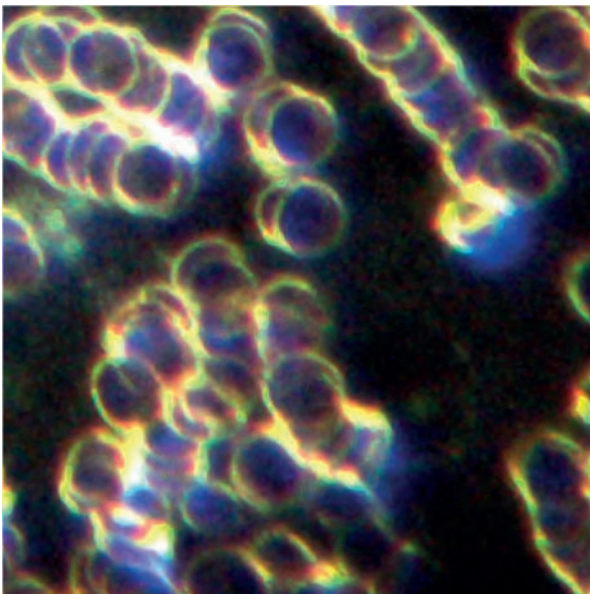


Dunkelfeldaufnahme nach
dem Telefonat mit
handelsüblichen
Smartphone nach
Harmonizer Mobile
harmonisieren


Proband 3 Harmonizer Mobile

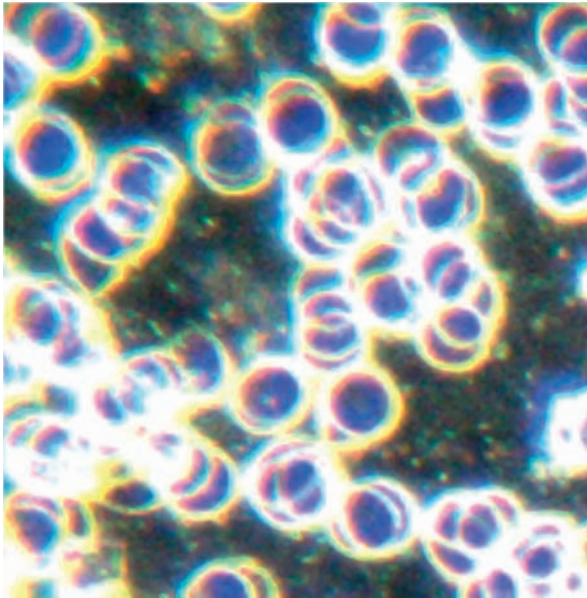

Dunkelfeldaufnahme vor
dem Telefonat

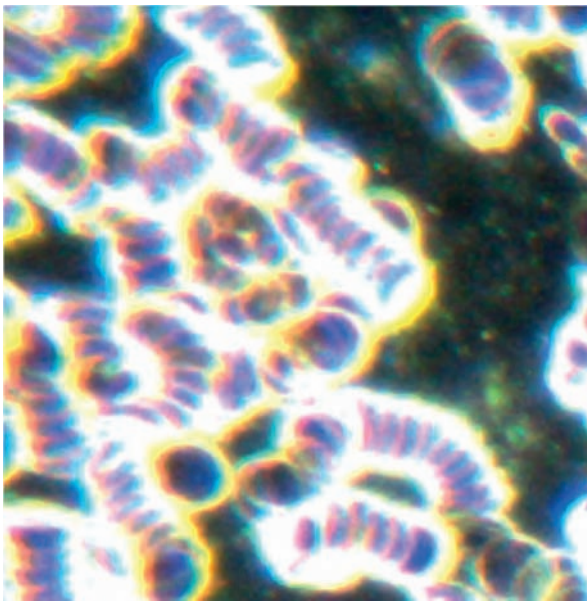


Dunkelfeldaufnahme nach
dem Telefonat mit
handelsüblichen
Smartphone

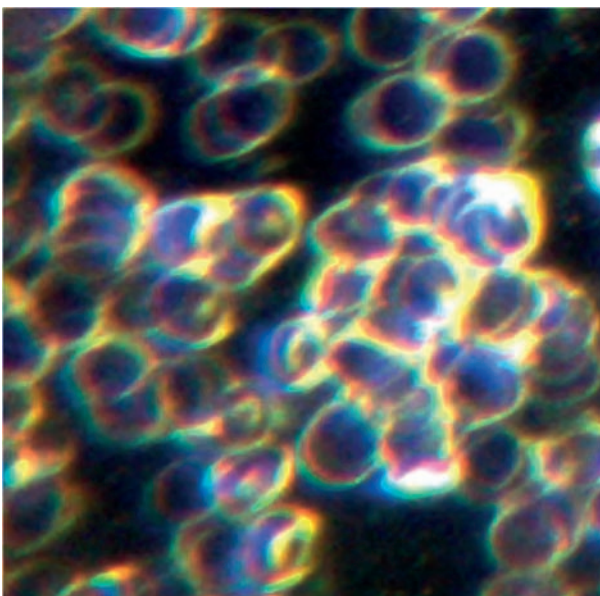


Dunkelfeldaufnahme nach
dem Telefonat mit
handelsüblichen
Smartphone nach
Harmonizer Mobile
harmonisieren


Proband 5 Harmonizer Mobile

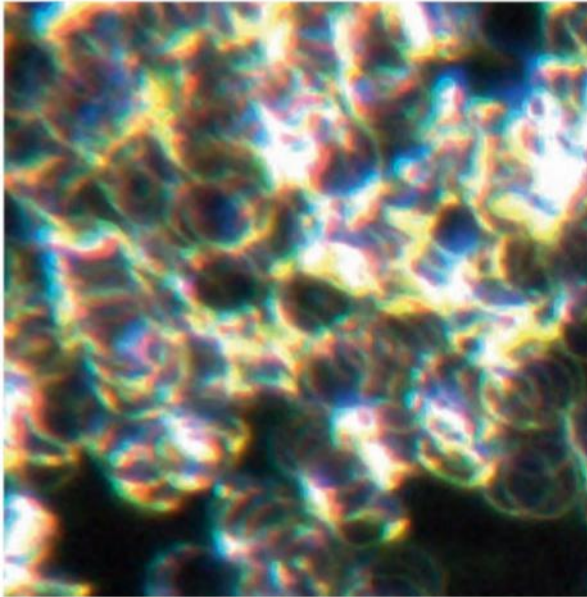

Dunkelfeldaufnahme vor
dem Telefonat

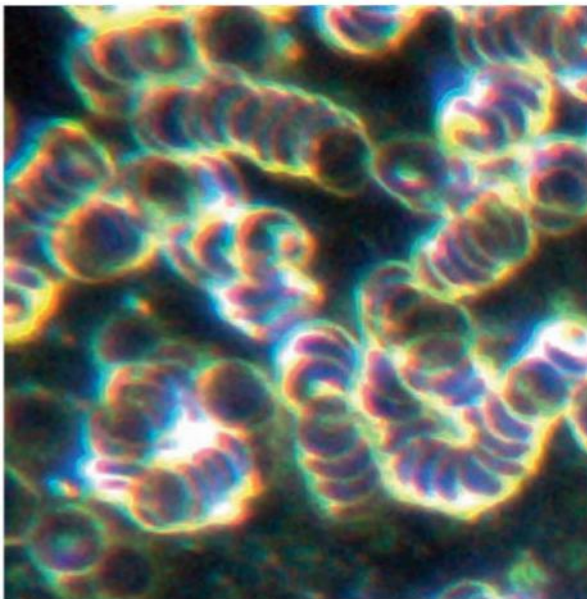

Dunkelfeldaufnahme nach
dem Telefonat mit
handelsüblichen
Smartphone

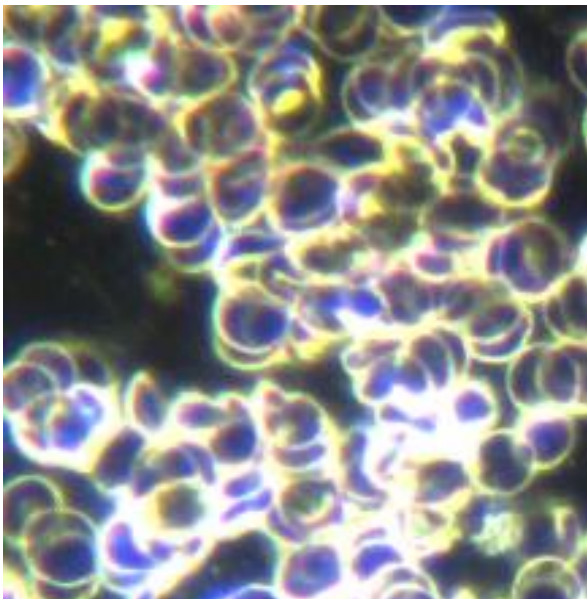

Dunkelfeldaufnahme nach
dem Telefonat mit
handelsüblichen
Smartphone nach
Harmonizer Mobile
harmonisieren

An die

Mondsee am 31.10.2014

Symbioceuticals-Harmonizer GmbH
Gangsteig 2
A-5082 Groedig

Betreff: Dunkelfeldvitalblutauswertungen von
Handybelastungen und ihre Harmonisierung!

Es wurden von mir in einem vorgegebenen Zeitraum eine Anzahl von Probanden auf Strahlenbelastungen vor und nach dem Handy Telefonieren mit Hilfe der Dunkelfelddiagnostik untersucht. Nach Anbringen des **Harmonizer Mobile** am Handy, konnte ich keine signifikante Veränderung der Erythrozyten mehr zum Ausgangsbild erkennen.

B1: sind Erythrozyten in der Blutbahn ohne Strahlenbelastung durch aktives Handytelefonieren

B2: während eine Handytelefonates verklumpen die Erythrozyten, der Blutfluss ist verlangsamt, die Belastung für das Kreislaufsystem steigt an!

B3: Fluss der Erythrozyten während eines Handytelefonates, das Handy wurde mit einem **Harmonizer Mobile** beklebt. Die roten Blutkörperchen bewegen sich frei und ungehindert!

med.univ.dr. gottfried schöler
energie & regulationsmedizin
hilfbergstraße 8
5310 mondsee österreich
tel: 0660 733 66 22



Dr. Gottfried Schöler